

6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶（6-PGDH）试剂盒

分光法 48 样

产品简介

6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶（6-PGDH，EC 1.1.1.43）是磷酸戊糖途径中关键酶之一，在维持细胞 NADPH 水平上起重要作用，与生物体能量平衡、生长速率和细胞活力等密切相关。

本试剂盒提供一种简单，灵敏，快速的测定方法：6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶催化 6-磷酸葡萄糖酸和 NADP+生成 NADPH。进而与特异显色探针反应生成有色物质，通过检测该有色物质的增加速率，计算出 6-PGDH 酶活性大小。

试剂盒组成和配制

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 50mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉剂 mg×1 瓶	4℃保存	用前甩几下使粉剂落入底部（量少，勿损失），再加 17.5mL 试剂一充分溶解，用不完的试剂 4℃保存。
试剂三	液体 1mL×EP 管	4℃保存	
标准品	粉剂 mg×1 支	-20℃保存	若重新做标曲，则用到该试剂。

所需的仪器和用品

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、低温离心机、水浴锅、可调式移液枪、和蒸馏水。

6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶 (6-PGDH) 活性测定

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

1、样本制备:

① 组织样本:

称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。12000rpm 4℃离心 15min, 取上清, 置冰上待测。

[注]: 若增加样本量, 可按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例提取。

② 液体样本:

直接检测。若浑浊, 离心后取上清检测。

2、上机检测:

① 可见分光光度计预热 30min 以上, 设置温度 25℃, 调节波长至 450nm, 蒸馏水调零。

② 试剂解冻至室温(25℃):

③ 在 1mL 玻璃比色皿中依次加入:

试剂名称 (μL)	测定管
样本	80
试剂一	360
试剂二	340
试剂三	20


混匀，25℃条件下，立即于450nm处读取A1值，20min后读取A2值，（观察：酶活性越大，则黄色越明显）。 $\Delta A = A2 - A1$ 。

[注]: 若 ΔA 过小，可以延长反应时间（如：60min或更长）再读取A2，或加大样本取样量（如增加到0.2g），重新调整的反应时间T需代入计算公式重新计算。

结果计算

1、标准曲线方程：

$y = 0.028x - 0.0015$, x 是 NADPH 摩尔质量 (nmol), y 是 ΔA 。

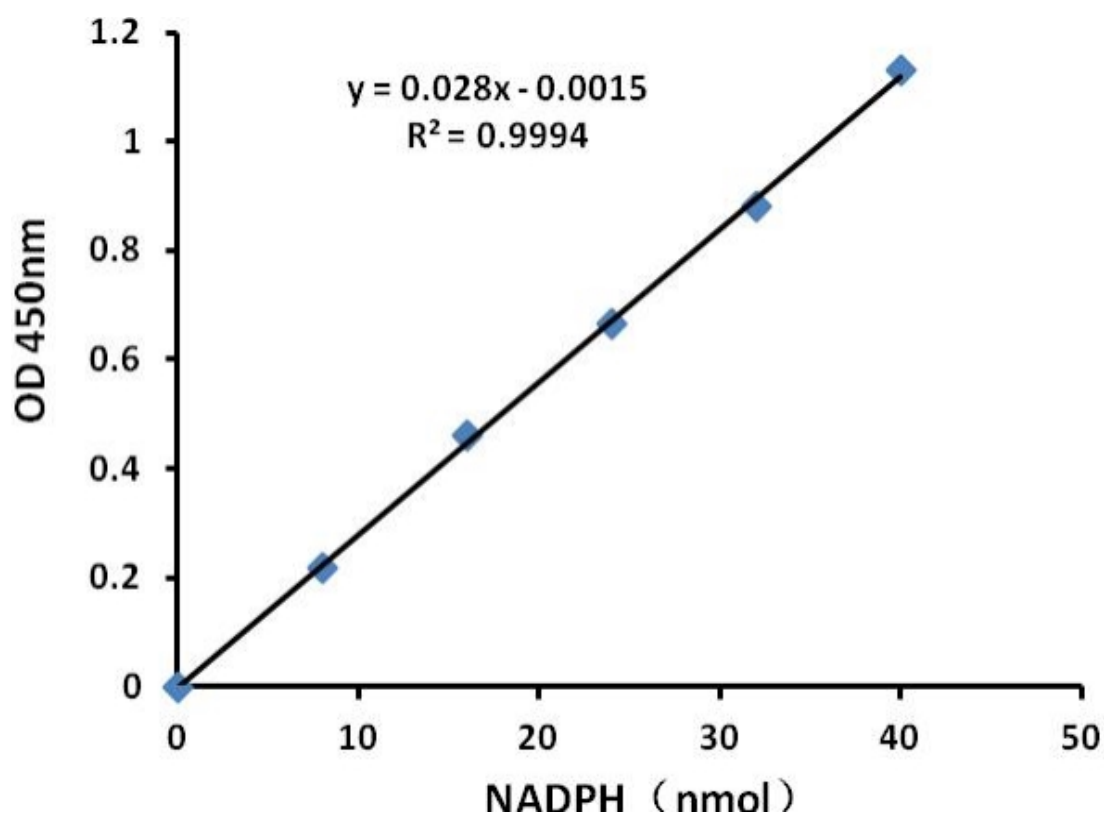

2、按蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克蛋白每分钟催化产生 1nmol NADPH 的酶量为 1 个酶活单位。

$$6\text{PGDH}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mg prot}) = [(\Delta A + 0.0015) \div 0.028] \div (\text{Cpr} \times V1) \div T$$

$$= 22.3 \times (\Delta A + 0.0015) \div \text{Cpr}$$

3、按样本鲜重计算:

酶活定义: 每毫升液体每分钟催化产生 1nmol NADPH 的酶量为 1 个酶活单位。

$$6\text{PGDH 酶活性}(\text{nmol}/\text{min}/\text{mL}) = [(\Delta A + 0.0015) \div 0.0795] \div V1 \div T$$

$$= 22.3 \times (\Delta A + 0.0015)$$

4、按细菌或细胞密度计算:

每毫升液体每分钟催化产生 1nmol NADPH 的酶量为 1 个酶活单位。6PGDH 酶活性

$$(\text{nmol}/\text{min}/\text{mL}) = [(\Delta A + 0.0015) \div 0.0795] \div V1 \div T$$

$$= 22.3 \times (\Delta A + 0.0015)$$

V----加入提取液体积, 1 mL; V1----加入样本体积, 0.08 mL;

W----样本质量, g。 T----反应时间, 20 min;

Cpr----样本蛋白质浓度, mg/mL; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附: 标准曲线制作过程:

1. 制备标准品母液 (1nmol/μL): 向标准品 EP 管里面加入 0.6mL 蒸馏水 (母液需在两天内用且-20℃保存)。

2. 把母液稀释成六个浓度梯度的标准品: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. nmol/μL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。

3. 按照 80μL 标准品+700μL 试剂一+20μL 试剂三, 根据结果即可制作标准曲线。